組み合わせ印 浸透タイプ

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。
ご使用中は必ず保管しておいてください。

構造と名称
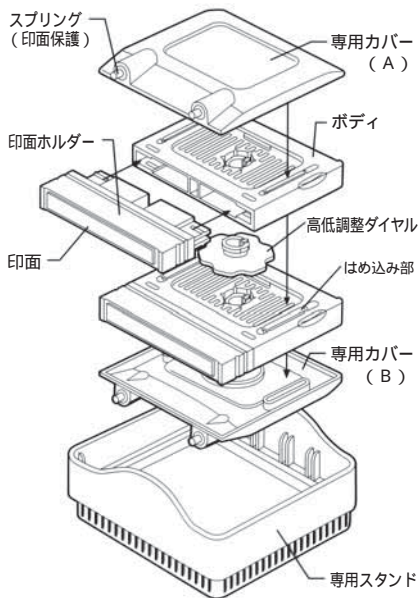
組替えのしかた

組合わせ印浸透タイプは組合せが自在にできます。下記のようにお望みの組合せに組替えてください。

（外す）
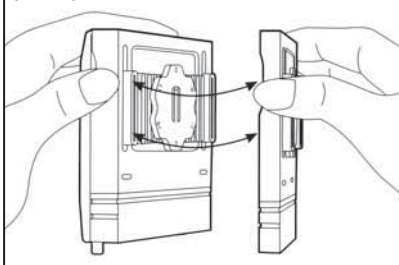
① ボディ側面を引っ張ると各ボディが外れます。

（はめ込む）
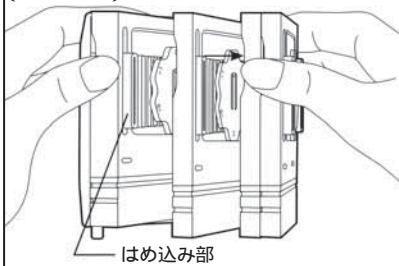
はめ込み部

② お望みのボディの並びに、はめ込み部を合わせてセットしてください。

注

1.両サイドのカバーを取り付けてご使用ください。

2.組替えのとき印面を手でふれるとまわりを汚すことがありますので、注意してください。

3.はめ込みにくい場合は、高低調節ダイヤルの位置を確認して下さい。

高低調節ダイヤルの位置のズレ

専用スタンドのご使用方法

組合わせ印浸透タイプは能率的に、きれいに捺印作業ができ、スッキリ収納できるよう、独自の専用スタンドを用意しています。

輸送時・引出し収納時

寝かせて収納

① 輸送時は図のように横向きにセットしています。
引出し等にしまう時もこのように収納すると、場所を取りません。

組合せ状態で使用中の収納

立てて収納

② ご使用いただく時は図のようにボディを立ててセットしてください。

※ スタンドの山型が正面になるように収納ください。

各ボディ個別で使用中の収納

号数に合わせて収納

③ 各ボディを別々に使用し、収納する時は図のように、山型のない方を正面に向けセットください。
スタンドには各ボディサイズ所定の仕切りがついています。それぞれのサイズに合わせた場所に収めてください。（単体収納のとき印面がスタンドの底に触れないようにしております）
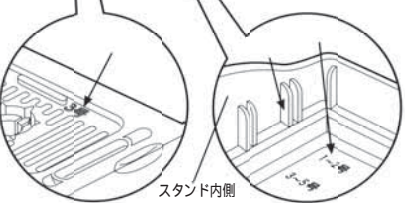
※ カバー専用の仕切りはありません。本体ボディ５本すべてがスタンドにセットされた場合カバーは別に保管してください。

インキの補充のしかた

■ 各ボディの印面インキカラーをよくお確かめの上補充してください。

■ 組み合わせ印浸透タイプは必ず専用補充インキ(別売)をご使用ください。
（他のインキを使用すると化学変化等で使用不能になることがあります）

1 ボディから印面ホルダーを外してください。
(ホルダーを引っ張ると外れます)

▶

2 印面ホルダーのインキ注入口２ヶ所に、専用補充インキを数滴注入してください。

▶
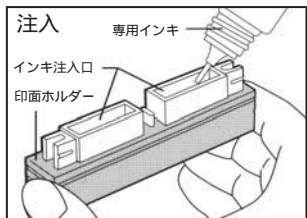
3 再び印面ホルダーをボディにしっかりセットしてください。

注 ※ 注入に際してはインキが手についたり、まわりを汚したりしないよう十分気をつけてください。
※ ホルダーを着脱するとき、高低調整ダイヤルを動かすことのないよう十分気をつけてください。
※ 一度インキの色を含浸させますと、色は変えられません。
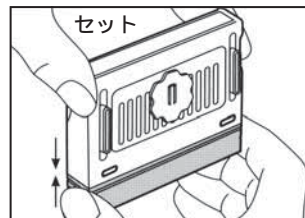
⚠ご使用上のご注意

- 表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色したりする恐れがあります。
- 印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は柔らかいブラシ等で掃除してください。
- カバーなしの単体でご使用になる場合は、そのまま放置すると手や書類を汚すもとになりますので、必ずスタンドにセット収納してください。
- 衣服等にインキがつくと、落ちませんので十分注意してください。
- 捺印以外の用途には使用しないでください。
- インキが手などについた場合は早めに石けんで洗い落としてください。また万一目に入った場合は、すぐ水道水で洗い、医師の診断を受けてください。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。

高低調整ダイヤルの使いかたは裏面をご覧ください。